CBS-B 程控全自动部份收集器

应用范围

CBS-B 程控全自动部份收集器采用悬挂式 X-Y 二维移动方式和等边方型的试管盘及拆卸方便的废液槽设计，具有移动方便、对管准确、废液分离等特点，是生物学研究、药物分析、农业科研、化工、食品及医疗等领域的仪器设备。仪器工作结束完毕后自动快速归位。还具有通过电磁阀控制，防止换管切换过程中的漏液现象，可与我厂生产的恒流泵和蠕动泵实现同步连接。 适用于生物，环境等领域。非腐蚀性液体的收集器。

产品介绍

CBS-B 程控全自动部份收集器是我厂根据用户要求以及吸收国外同类仪器优点而研制开发的新产品。与原 BSZ、BS 系列等收集器相比，CBS-A/B 程控全自动部份收集器具有自动对管、耐有机溶液等特点。通过液晶显示屏及菜单导航指示能进行定时、定滴、程控收集等多功能操作，并可根据需要选用多种规格的试管盘，实现一机多用，降低使用成本。

产品特点

1. **独立触摸彩屏菜单式操作**；采用 7 寸高清全彩电容触摸液晶屏 1024*600，图形模式，多层菜单式操作，实现一机多用，降低使用成本。
2. 独特的菜单式操作流程。按面板上的“简明操作流程图”即能完成各功能的操作，使用及其方便。

3. 方型设计及悬挂式的 X－Y 移动。采用方型设计及悬挂式的 X－Y 移动方式，换管定位精确；收集溶液与电路分离，使用更安全。

4. 耐腐蚀设计。适用于水溶性溶济和有机溶剂的柱层析分离实验。（另选配耐有机安全阀配置费用另加）

5. 可编程控制。采用微处理器控制，用户可通过操作菜单，根据色谱图自行编制收集程序。

6. 可设置延迟收集时间。通过编程设置延迟收集时间，以补偿从检测器出口到收集管的时间，确保样品精确流入对应试管。

7. 电磁阀换管控制。通过电磁阀控制，防止换管切换过程中的漏液现象。

地 址：上海市奉贤区金碧路1980弄66号
邮 编：201403 传 真：021-67865155
电 话：021-67865155
手 机：18964005752 13761135354
网 址：www.shwx17.net
邮 箱：1926164751@qq.com

技术参数

收集试管：63 支(每支最大容量：60ml)可更换不同试管架或者瓶；（**可选择 130 支*12ml**，订货时另请说明。）

定时范围：每支试管可以设定 1 秒—999 小时 59 很 59 秒任意选择不同时间；

定滴范围：每支试管可以设定 1---1 万滴任意选择不同滴数；

定峰范围：±正负 5V　分辨率 0.01mV 任意选择；

程控范围：1－130 段任意选择；

移动方式：悬挂式 X－Y 移动，可编程控制；

换管控制：12V 直流电磁阀；

操作方式：中英文图形模式，多层菜单式操作；

习惯性存储：1－64 个/模式；

断电数据保存：十年，16M 存储可保存海量数据；

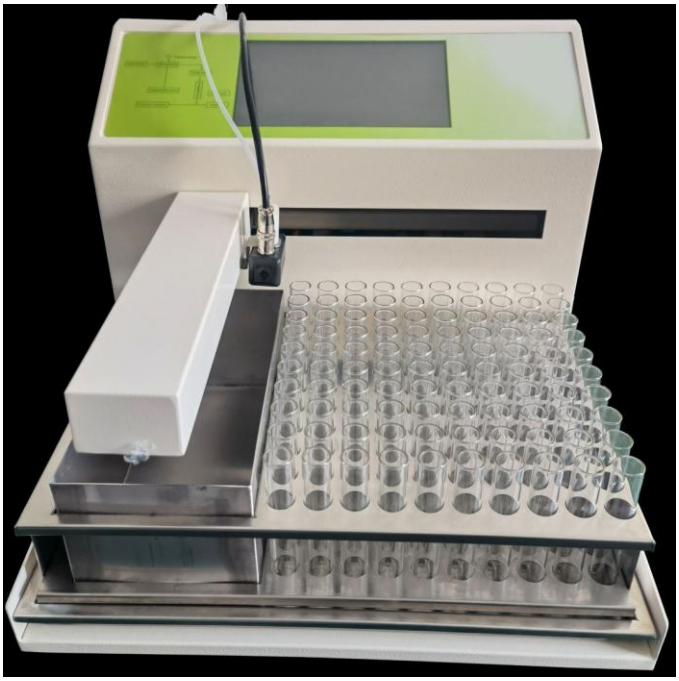

上海五相仪器仪表有限公司
Shanghai Wuxiang Instrument Co., Ltd.
地 址：上海市奉贤区金碧路1980弄66号
邮 编：201403　传 真：021-67865155
电 话：021-67865155
手 机：18964005752　13761135354
网 址：www.shwx17.net
邮 箱：1926164751@qq.com